

Bearbeitung des DAHZ/BZÄK-Hygieneplans im Adobe Reader XI

Mit der neuen Version stehen zusätzliche Möglichkeiten für die Bearbeitung von Formularen zur Verfügung.

Streichung nicht eingesetzter Verfahren:

Kommentar – Grafikmarkierungen – Linie

Linie über den zu streichenden Bereich ziehen

The screenshot shows the Adobe Reader XI interface. The main content is a table titled "semikritisch A (maschinelle Verfahren)". The table has four columns: "WIE", "WOMIT", "ANWEISUNGEN", and "WER". A red diagonal line is drawn across the "WIE" column. A blue arrow points from the "Grafikmarkierungen" toolbar on the right to the red line. The toolbar includes options for "Anmerkungen", "Grafikmarkierungen", and "Kommentarliste (6)".

	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
ittelle,	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">nach jeder Verwendung am Patienten	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten befasst sind
men	oder Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validiert wurde	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zeilstofftücher entfernen)	
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator)*	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)	
	oder			

Mit Mausklick rechts können die Eigenschaften der Linie geändert werden:

The screenshot shows the "Linien-Werkzeug - Eigenschaften" dialog box. It has two tabs: "Erscheinungsbild" and "Allgemein". The "Allgemein" tab is selected. The dialog contains the following settings:

- Anfang: Kein
- Ende: Kein
- Stil: —
- Stärke: 1 pt
- Farbe: [Red square]
- Füllfarbe: [Red square with diagonal line]
- Deckkraft: 100%

At the bottom, there is a checkbox for "Gesperrt" (unchecked), and "OK" and "Abbrechen" buttons.

Zufügen von eigenem Text

Ausfüllen und Unterschreiben – Text hinzufügen

Mausklick auf dem Bereich, der beschriftet werden sollte

Text eingeben

ggf. Texteigenschaften anpassen

The screenshot shows a software interface with a top toolbar containing icons for undo, redo, comment, and text addition. The main menu has three tabs: 'Werkzeuge', 'Ausfüllen und Unterschreiben' (highlighted), and 'Kommentar'. Below the menu is a 'Vorhandene Felder markieren' button. A 'Text hinzufügen' dialog box is open, showing a text input field with 'Text hinzufügen', a font dropdown set to 'Helvetica', and a size dropdown set to '9'. A red arrow points from the 'Text hinzufügen' button in the right-hand menu to the dialog box. The right-hand menu also includes options like 'Häkchen hinzufügen', 'Initiale platzieren', and 'Unterschrift platzieren'. Below the menu is a table with three columns: 'WOMIT', 'ANWEISUNGEN', and 'WER'. The table contains instructions for hand hygiene, including the use of liquid soap and drying with a towel. A yellow box highlights the text 'Dies ist eingefügter Text' in the 'ANWEISUNGEN' column.

	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
	Flüssigwaschpräparat aus Direktspender Trocknen mit Handtuch zum Einmalgebrauch (Box, Spender)	<ul style="list-style-type: none">• vor Arbeitsbeginn• bei sichtbarer Verschmutzung• nach Arbeitsende <p>Dies ist eingefügter Text</p>	alle Beschäftigten
hende während	Händedesinfektionsmittel aus Direktspender (A)		

Abdecken nicht benötigter Bereiche:

Kommentar – Grafikmarkierungen – Rechteckwerkzeug

Über Rechtsklick Eigenschaften aufrufen:

„Farbe“ und „Füllfarbe“ auf Weiß / 100% Deckkraft setzen

Rechteck über abzudeckende Bereiche ziehen.


The screenshot shows a software interface with a table and a right-hand toolbar. The table is titled "semikritisch A (maschinelle Verfahren)" and has four columns: WIE, WOMIT, ANWEISUNGEN, and WER. The first row contains text under "WIE" and "WER". The "WOMIT" column has three rows, each with a "Gerät / Programm:" label. A blue arrow points from a yellow rectangle in the "Grafikmarkierungen" section of the toolbar to the first "Gerät / Programm:" cell in the table.

semikritisch A (maschinelle Verfahren)			
WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">nach jeder Verwendung am Patienten	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind
	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstoffpapier entfernen)	
	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)	
oder Verfahren 3:	Gerät / Programm:		

The screenshot shows a dialog box titled "Rechteck - Eigenschaften". It has two tabs: "Allgemein" (selected) and "Überprüfungsverlauf". Under "Allgemein", there are settings for "Stil" (a dropdown menu), "Stärke" (1 pt), "Farbe" (a color selection box), "Füllfarbe" (a color selection box), and "Deckkraft" (100% with a slider). At the bottom, there are checkboxes for "Gesperrt" and "Eigenschaften als Standard festlegen", and "OK" and "Abbrechen" buttons.

Beispiele für die Bearbeitung des DAHZ/BZÄK-Hygieneplans mit dem Adobe Reader DC

Kommentarwerkzeug aus der Seitenleiste auswählen

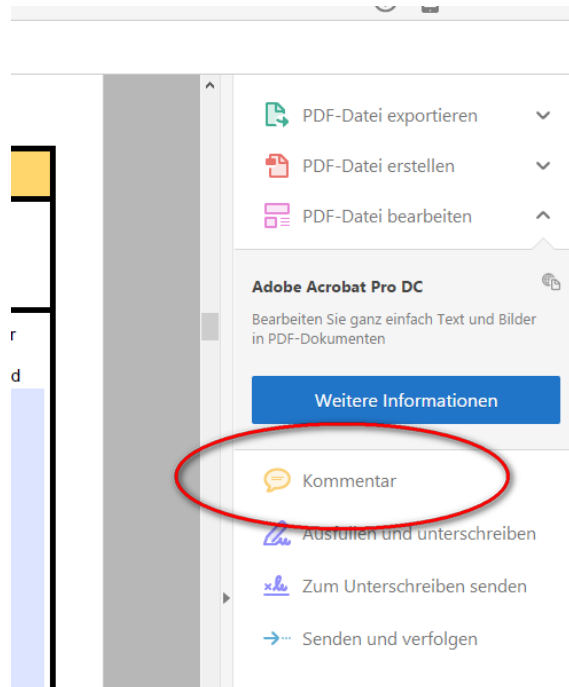

z.B. Streichung nicht eingesetzter Verfahren mit dem Werkzeug „Linie zeichnen“

Start Werkzeuge Hygieneplan DAHZ... x

Linie zeichnen

Kommentar

Medizinprodukte semikritisch A (maschinelle Verfahren)				
WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	W
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen) ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen) 	alle Beschäftigt Aufbereitung v Medizinprodukt
	oder Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validebar ist	Gerät / Programm:		
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *	Gerät / Programm:		

z.B. Einfügen von zusätzlichem Text mit dem Werkzeug „Textkommentar hinzufügen“:

Kommentar ▾

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten
	oder	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen)
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator)*	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)

Zusätzlicher Text

z.B. Anhängen von Dokumenten (z.B. Arbeitsanweisungen) mit dem Werkzeug „Datei anhängen“

Kommentar ▾

Medizinprodukte semikritisch A (manuelle Verfahren)			
WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)	Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwe Patienten
		Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> ggf. weitergehen Vorbereitung (z.B. Zerlegen)